


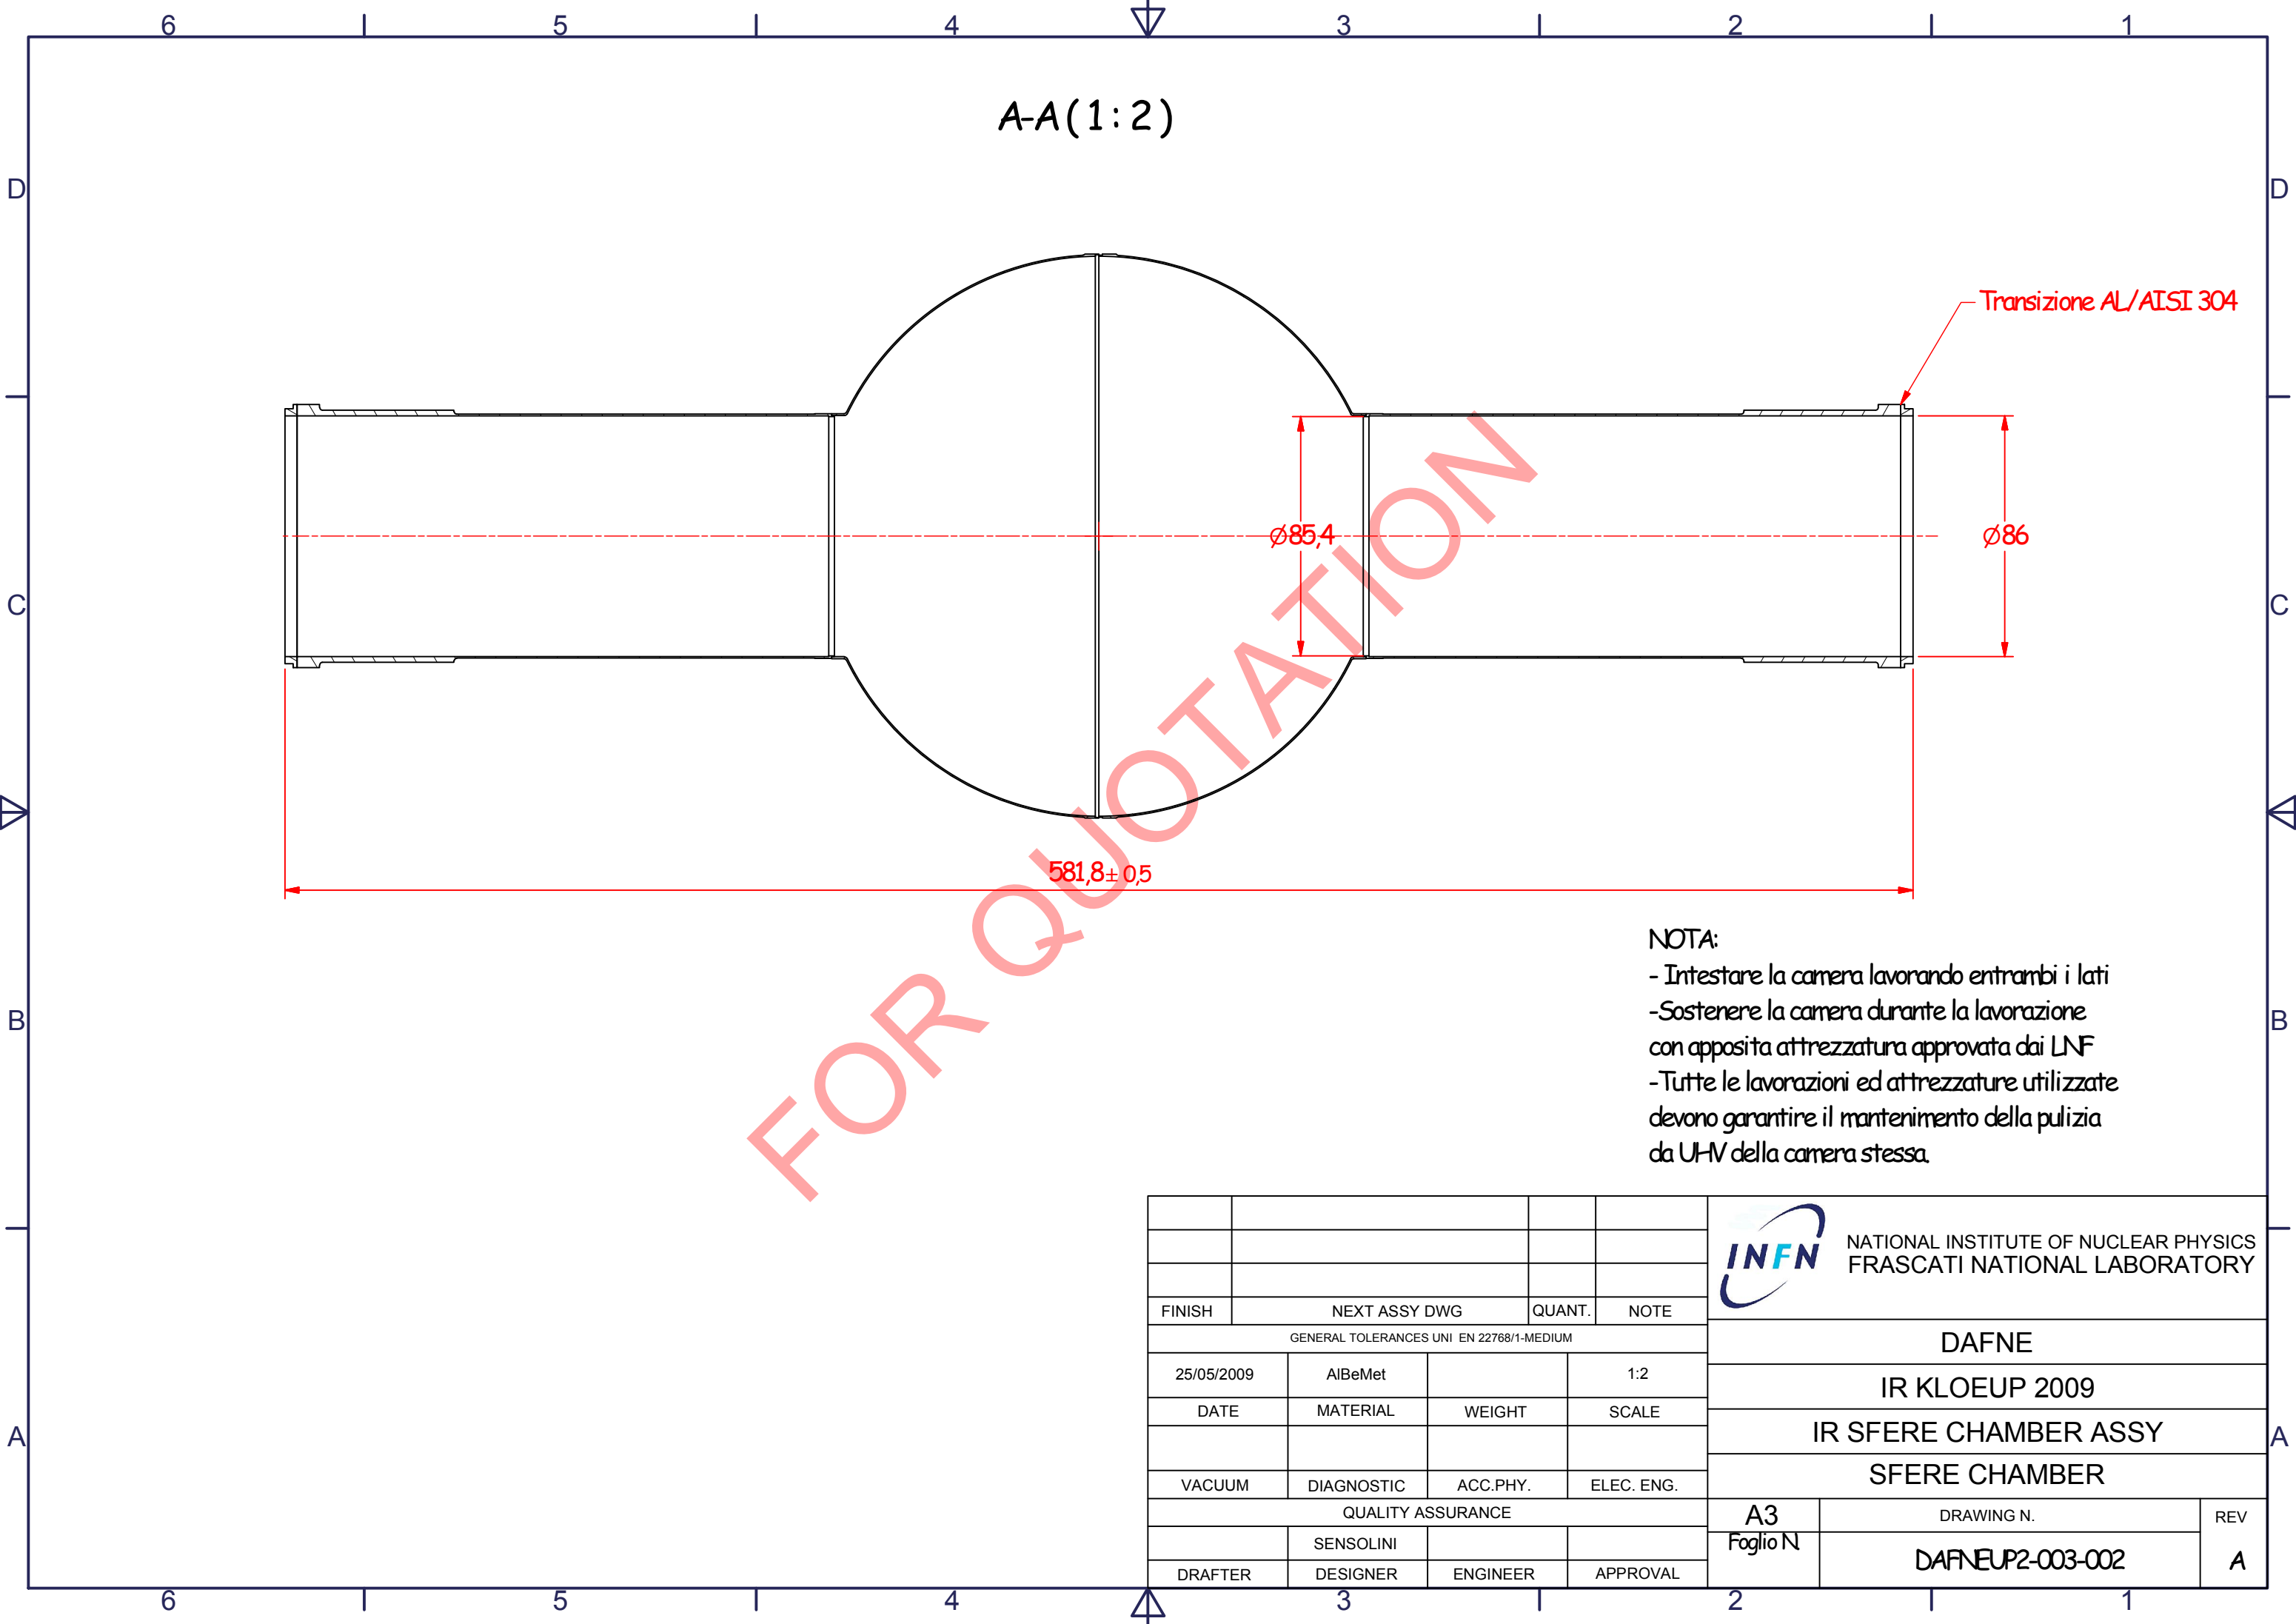

NOTA:

- Intestare la camera lavorando entrambi i lati
- Sostenere la camera durante la lavorazione con apposita attrezzatura approvata dai LNF
- Tutte le lavorazioni ed attrezzature utilizzate devono garantire il mantenimento della pulizia da UHV della camera stessa.

				 NATIONAL INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS FRASCATI NATIONAL LABORATORY		
FINISH	NEXT ASSY DWG	QUANT.	NOTE			
GENERAL TOLERANCES UNI EN 22768/1-MEDIUM				DAFNE		
25/05/2009	AlBeMet		1:2	IR KLOEUP 2009		
DATE	MATERIAL	WEIGHT	SCALE	IR SFERE CHAMBER ASSY		
				SFERE CHAMBER		
VACUUM	DIAGNOSTIC	ACC.PHY.	ELEC. ENG.			
QUALITY ASSURANCE				A3	DRAWING N.	REV
	SENSOLINI			Foglio N	DAFNEUP2-003-002	A
DRAFTER	DESIGNER	ENGINEER	APPROVAL			