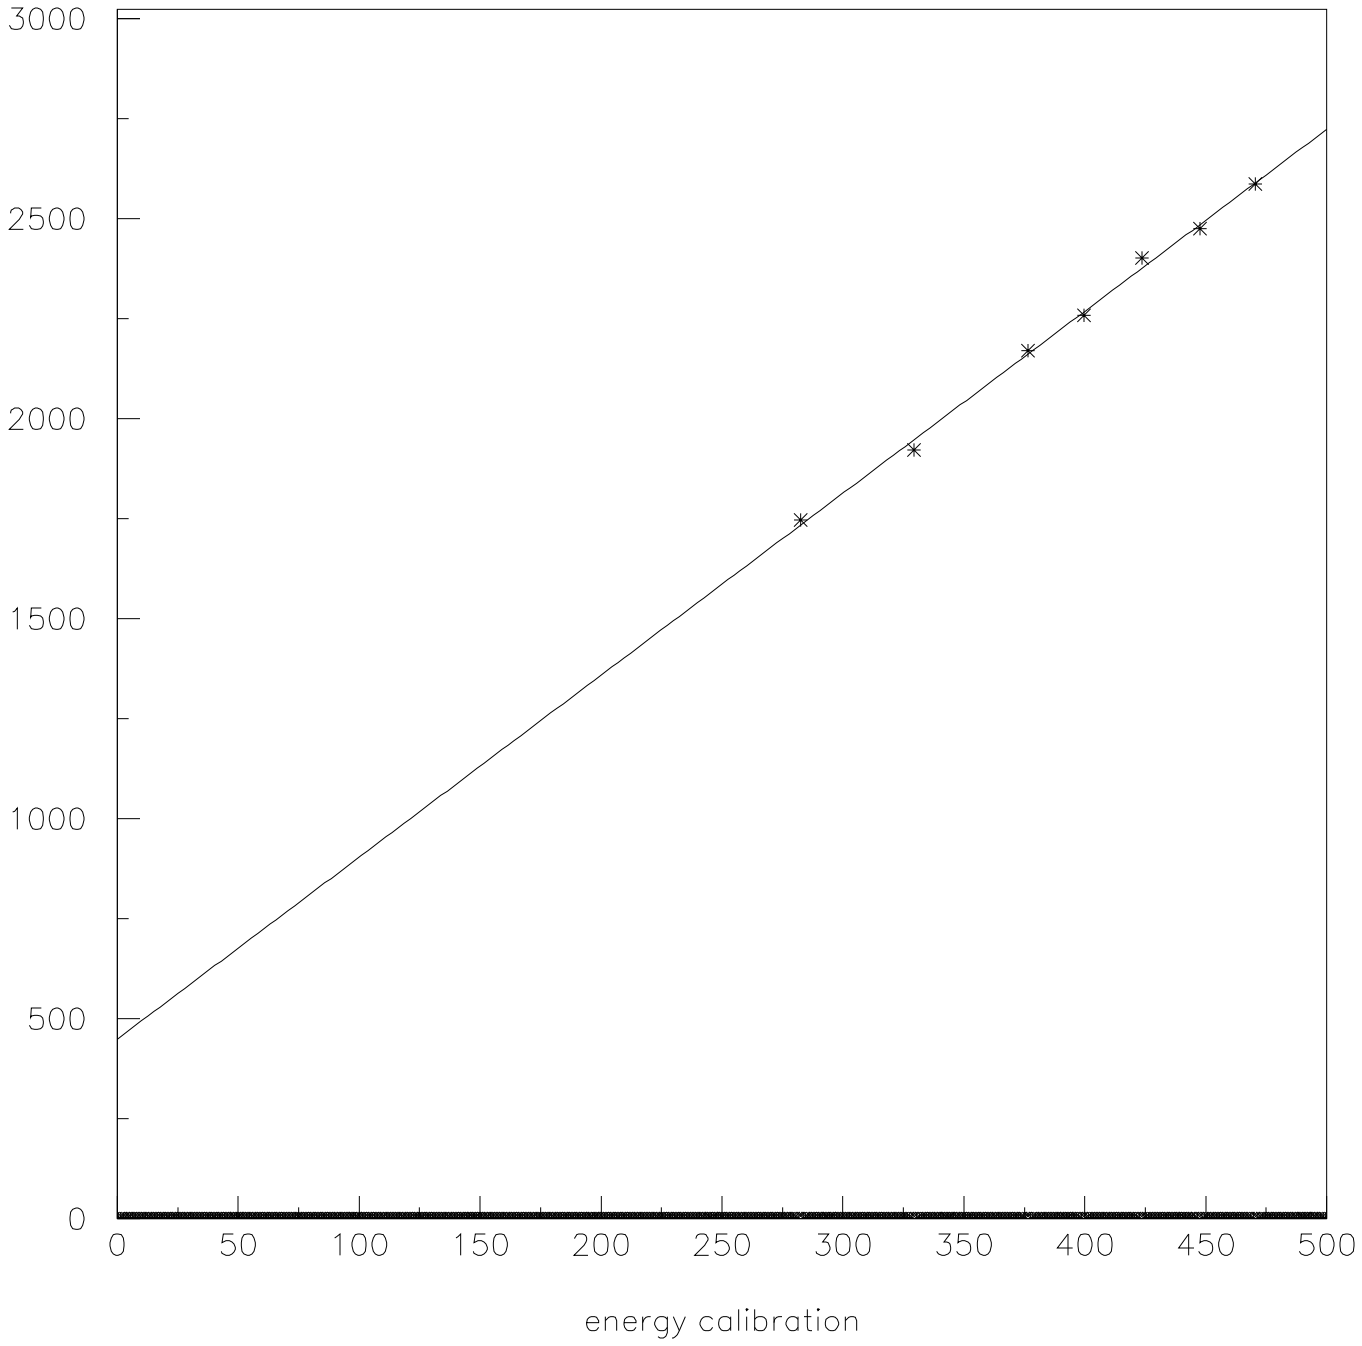
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
energy calibration